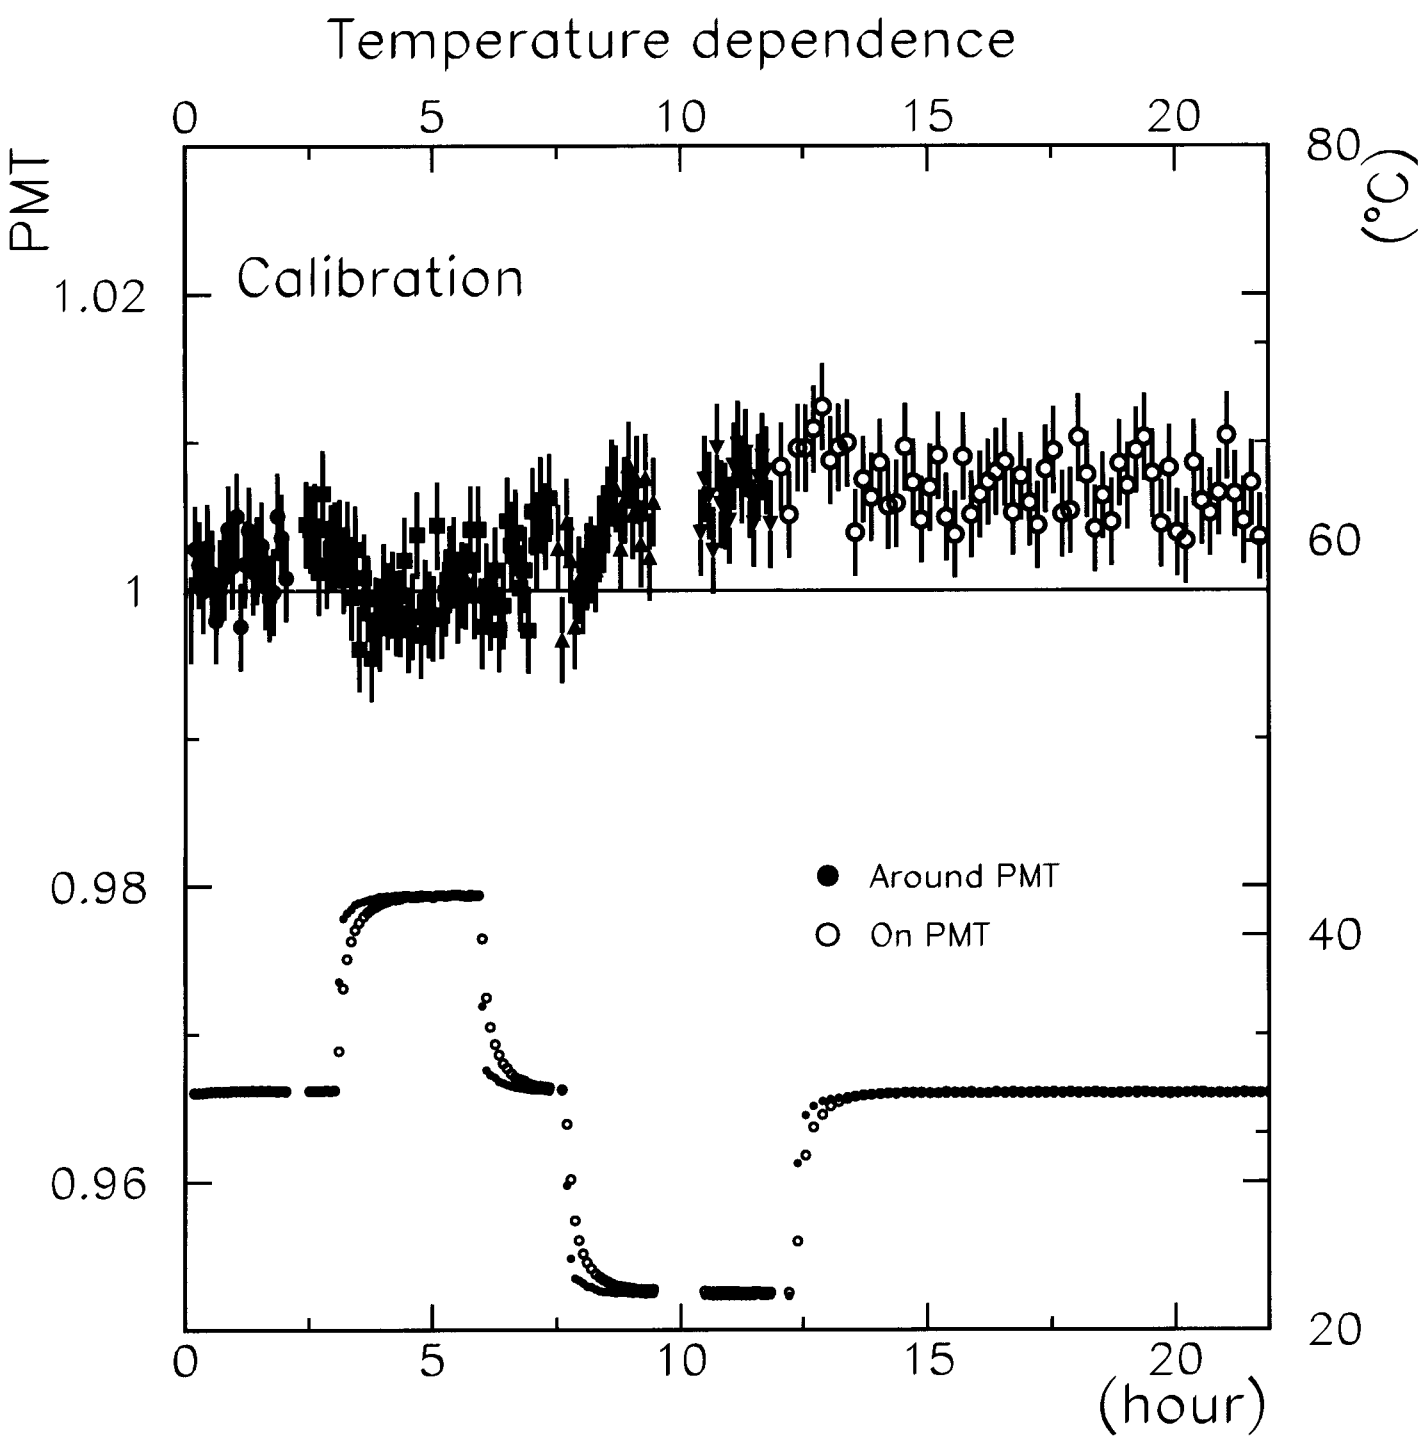
Temperature dependence
0
5
10
15
20
80
(°C)
PMT
Calibration
1.02
1
0.98
0.96
60
40
20
Around PMT
On PMT
0
5
10
15
20
(hour)

384
ch

~ 150 ns